

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
 この度、下記検査項目の検査内容を変更させて頂きたくご案内いたします。  
 何卒ご高承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬白

### 記

- 実施日 : 即日
- 変更項目 : アンドロステンジオン
- 変更内容 :

項目コード	検査項目 (グループコード)	変更内容	新	現	備考	検査案内書 掲載ページ
1052	アンドロステンジオン  (5437)	検体必要量	血清 0.5mL	血清 0.4mL	委託先による変更 (現測定試薬の販売中止に伴う変更。)	32
		容器	A1→G-1	A1-1		
		保存方法	凍結	冷蔵		
		基準値	下記参照			
		所要日数	9~15日	4~10日		
		測定施設	エスアールエル 経由 あすか製薬メディカル	エスアールエル		
		報告上限	99999999 (ng/mL)	99000000 (ng/mL)		
		報告下限	0.10未満 (ng/mL)	0.1以下 (ng/mL)		

### ◆ 変更前後の基準値

[ 変更後 ]

(単位:ng/mL)


年齢(歳)	男性	女性
20~29	0.48~1.82	0.64~2.34
30~39	0.42~1.52	0.57~2.24
40~49	0.46~1.67	0.28~1.35
50~59	0.41~1.57	0.25~1.21

[ 変更前 ]

(単位:ng/mL)

年齢(歳)	男性	女性
20~29	1.2~2.5	1.1~3.9
30~39	1.0~3.2	0.9~3.5
40~49	1.0~2.9	0.6~2.2
50~59	1.0~2.5	0.3~2.1
60以上	0.6~2.7	0.3~2.0

◆ 現試薬と新試薬の比較

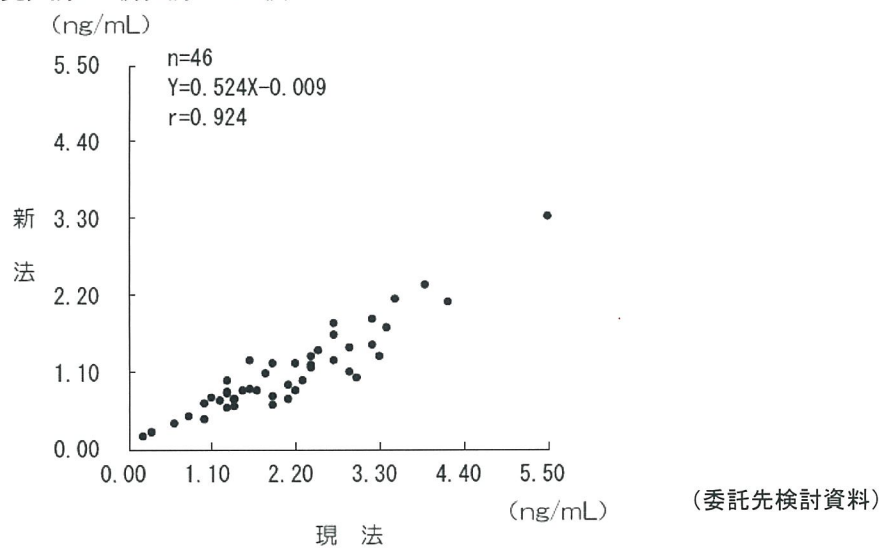

◆ 参考文献

吉田 孝雄、他：ホルモンと臨床 22 (5) : 671 -676 , 1974